



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

Memorando/Lab nº 40/2017

Para: NAF/SMSA

Araucária, 25 de abril de 2017

Informamos através deste os resultados do Teste dos glicosímetros realizados no Laboratório Municipal de Araucária no dia 20 de abril de 2017.

Foram testados 3 glicosímetros da marca On Call Plus denominados:

GLICOSIMETRO 1 - 1035009A489

GLICOSIMETRO 2 - 1035009A4B6

GLICOSIMETRO 3 - 1035009A499

Foram selecionados aleatoriamente alguns pacientes agendados para coleta no laboratório neste dia, determinado a glicose no glicosímetro com a amostra coletada de sangue venoso com seringa e usado a mesma amostra no tubo com gel separador e determinado a glicemia no equipamento Abbott C8000. Foram testados 36 amostras nos 3 glicosímetros.

Desempenho dos glicosímetros:

GLICOS 1 = 75 % dos valores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ISO 15197:2003

GLICOS 2 = 81 % dos valores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ISO 15197:2003

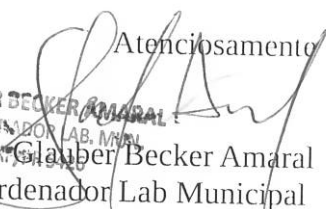
GLICOS 3 = 78 % dos valores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ISO 15197:2003.

Segundo ISO 15197:2003, 95 % dos valores individuais de glicose obtidos nos glicosímetros devem estar dentro dos parâmetros abaixo descritos, quando comparados com os valores obtidos no Analisador bioquímico do Laboratório

Glicemia abaixo de 75 mg/dL: abaixo de 15 mg/dL

Glicemia acima de 75 mg/dL: dentro de 20 %

Desde já agradeço a atenção dispensada, estamos a disposição para esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente

GLAUBER BECKER AMARAL
COORDENADOR LAB. MUN.
Glauber Becker Amaral
Coordenador Lab Municipal