



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

Memorando/Lab nº 40/2017

Para: NAF/SMSA

Araucária, 04 de maio de 2017

Informamos através deste os resultados do Teste dos glicosímetros realizados no Laboratório Municipal de Araucária no dia 04 de maio de 2017.

Foram testados 2 glicosímetros da marca ROCHE modelo: Accu – Chek Active denominados:

GLICOSIMETRO 1 - GU21490756

GLICOSIMETRO 2 – GU21490758

Foram selecionados aleatoriamente alguns pacientes agendados para coleta no laboratório neste dia, determinado a glicose no glicosímetro com a amostra coletada de sangue venoso com seringa e usado a mesma amostra no tubo com anticoagulante fluoreto de sódio e determinado a glicemia no equipamento Abbott C8000. Foram testados 56 amostras em cada glicosímetro.

Desempenho dos glicosímetros:

GLICOS 1 = 98,2 % dos valores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ISO 15197:2003

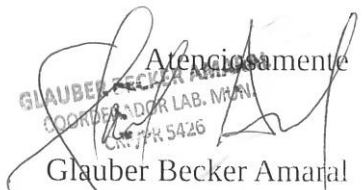
GLICOS 2 = 98,2 % dos valores estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ISO 15197:2003

Segundo ISO 15197:2003, 95 % dos valores individuais de glicose obtidos nos glicosímetros devem estar dentro dos parâmetros abaixo descritos, quando comparados com os valores obtidos no Analisador bioquímico do Laboratório

Glicemia abaixo de 75 mg/dL: abaixo de 15 mg/dL

Glicemia acima de 75 mg/dL: dentro de 20 %

Desde já agradeço a atenção dispensada, estamos a disposição para esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente

Glauber Becker Amaral
Coordenador Lab Municipal

41 3614-1470

Rua Pedro Druszczyk, 111 - CEP 83702-080 - Centro - Araucária / PR